


## 【売払い機器の概要】

整理番号5

項目	内容
1. 名称	熱分析システム
2. メーカー	(株)マック・サイエンス
3. 型式	TG部 TG-DTA2000S DSC部及び制御部 DSC3100S 電源トランス MTC1000S
4. 購入年月	平成10年12月
5. 本体外形寸法	幅 1.0 m×奥行 0.5 m×高さ 0.5 m
6. 重量	約 30 KG
7. 機器の内訳	本体 ①TG部 ②DSC部及び制御部 ③データ表示PC ④電源トランス ※14. 機器の写真-本体-①～④をご参照下さい。 付属品 プリンター(インク切れ状態)
8. 機器の状態	DSC部は正常に稼働しますが、TG部は破損しており使用できません。
9. 取扱説明書	付属しています・ <del>付属していません</del>
10. 搬出上の注意	一人で搬出可能です。
12. 搬出期限	平成30年1月31日(水)17時までに、機器の引取りを完了して下さい。
13. その他条件等	①搬出作業は、買受人の負担により実施して下さい。 ②装置取り外し後の部屋の復旧は基本的に求めません。ただし、引き取りに伴い施設を破壊した場合は、破損箇所の修復を購入者の負担により実施して頂きます。 ③売払い機器の動作については、当センターとしては一切保証致しません。現状引き渡しとなりますので、今後の動作保証も一切致しません。また、当センターは、購入後の修理の可能性や修理後に発生した故障をはじめ、本機器に関する一切の責任について、これを負いません。

14. 機器の写真

本 体

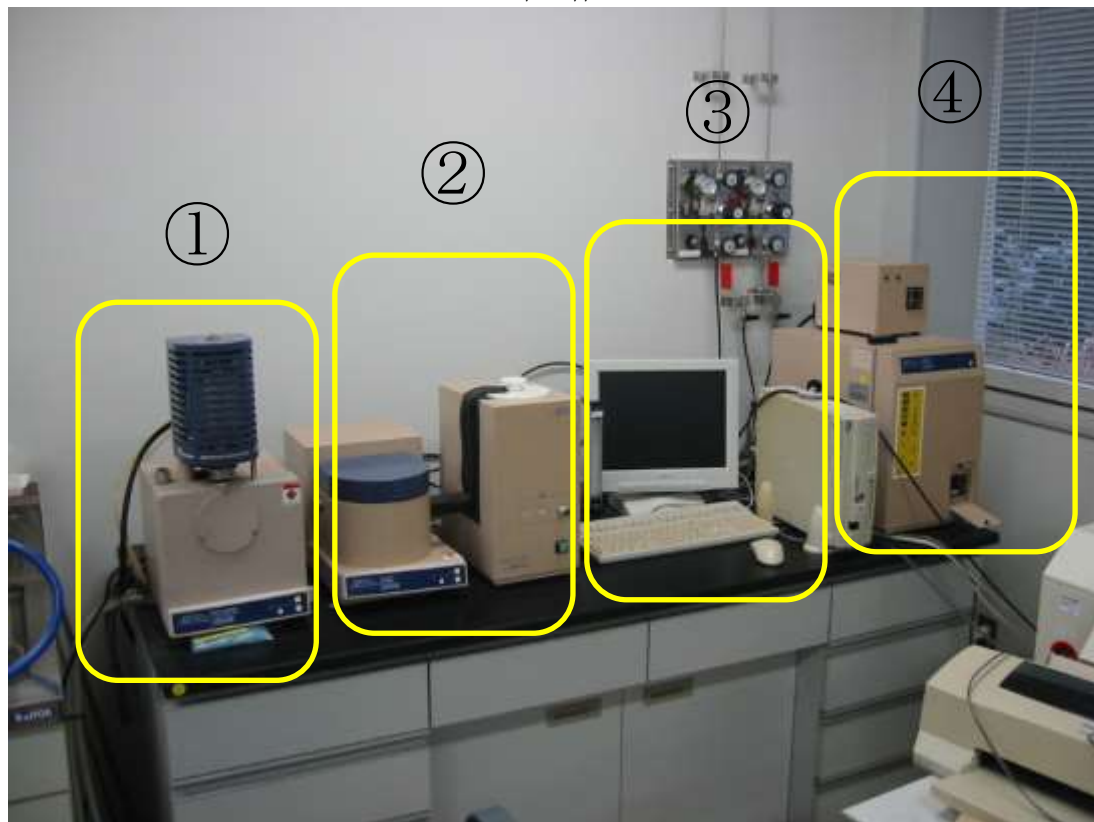

付属品(プリンター)

